

仕 様 書

この仕様書は、手提げ袋 透明ビニールバッグ 中サイズ マチ付 特注 外1件（以下「物品」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）・メーカー名・数量等

品名	規格（型番）	メーカー名	数量
手提げ袋 透明ビニールバッグ 中サイズ マチ付 特注	厚さ 0.3 mm W370×H380 mm マチ 90 mm 軟質塩化ビニール（透明） ポケット有 ポリエステルロープ ハトメ	(株)やまひ	50 枚
手提げ袋 透明ビニールバッグ 大サイズ マチ付 特注	厚さ 0.3 mm W505×H440 mm マチ 135 mm 軟質塩化ビニール（透明） ポケット有 ポリエステルロープ ハトメ		50 枚

特記事項

1. 仕様の詳細は、別紙のとおりとする。

2 一般的条項

- ① 受注者は、物品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 物品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和 3 年 7 月 30 日（金）

なお、予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 中央棟 3 階 中央手術室【担当：山下】
(広島市中区基町 7 番 33 号)

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、物品の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本物品検査受領後 1 年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する物品の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

I. 品 名 手提げ袋 透明ビニールバッグ 中サイズ マチ付 特注


II. 素 材 (株)やまひ 軟質塩化ビニール (透明) 厚さ 0.3 mm

- III. 仕 様
- ポケット有 タテ 110 × ヨコ 250
 - 持ち手はポリエステルロープ
 - ハトメを取り付ける

IV. サ イ ズ (mm)

規 格	巾 (W)	高さ (H)	マチ	枚 数
中サイズ	370	380	90	50 枚

V. 図

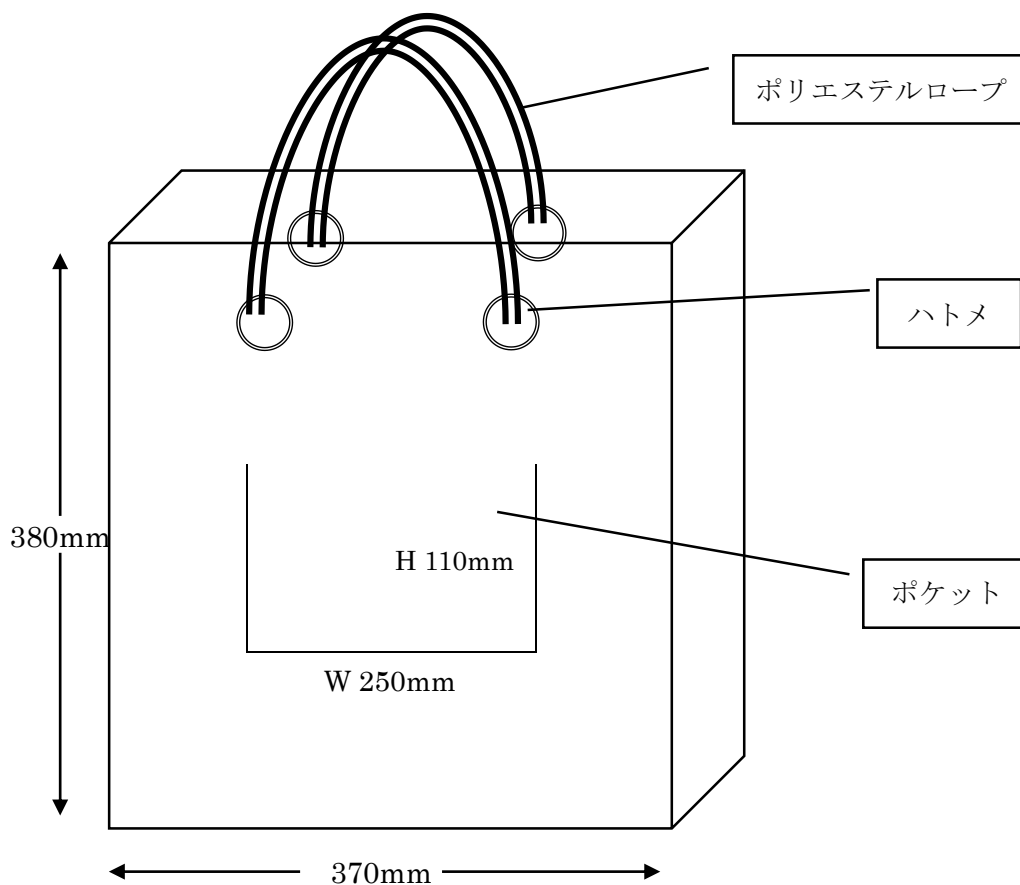

I. 品 名 手提げ袋 透明ビニールバッグ 大サイズ マチ付 特注

II. 素 材 (株)やまひ 軟質塩化ビニール (透明) 厚さ 0.3 mm

III. 仕 様
○ ポケット有
○ 持ち手はポリエステルロープ
○ ハトメを取り付ける

IV. サ イ ズ (mm)

規 格	巾 (W)	高さ (H)	マチ	枚 数
大サイズ	505	440	135	50 枚

V. 図

